

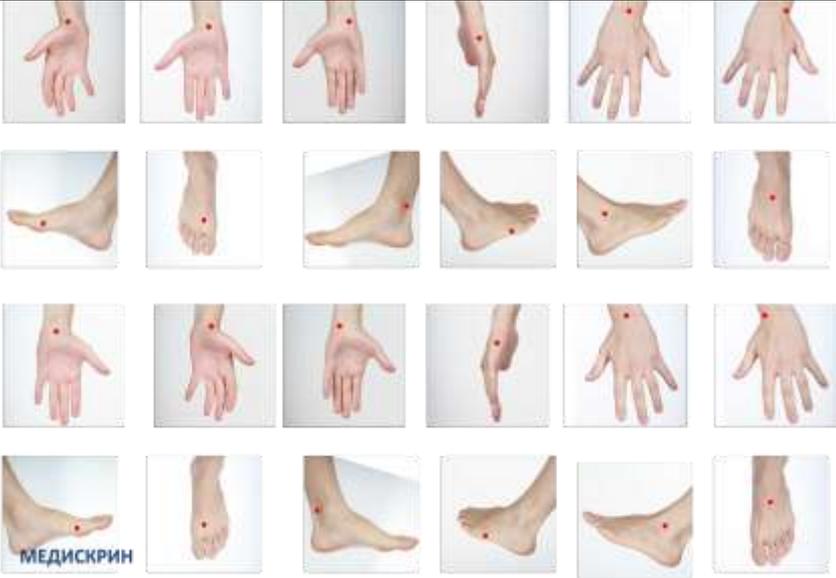



Рисунок	Текст
	<p>Смочить ватный диск водой до состояния, когда при отжимании капают капли с диска</p>
	<p>Протереть спиртом «носик» активного и диск пассивного электродов прибора</p>
	<p>Протереть спиртом зоны съема на руках и ногах</p>
	<p>Включить программу МЕДИСКРИН на компьютере</p>

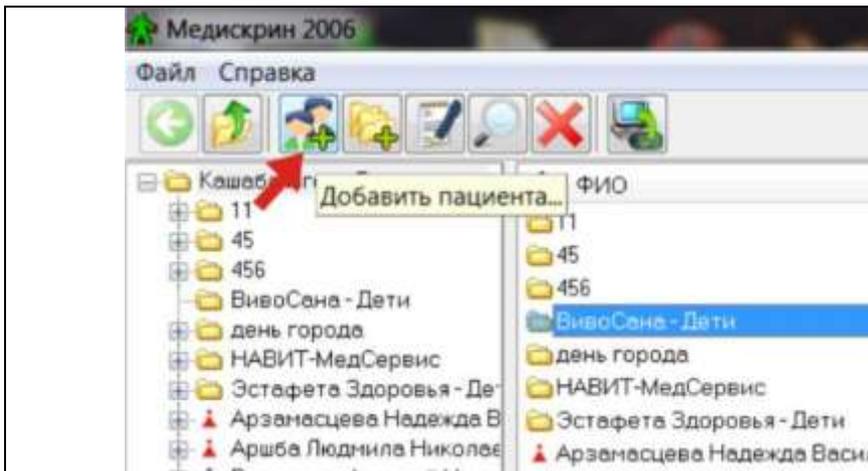


Добавить нового пациента

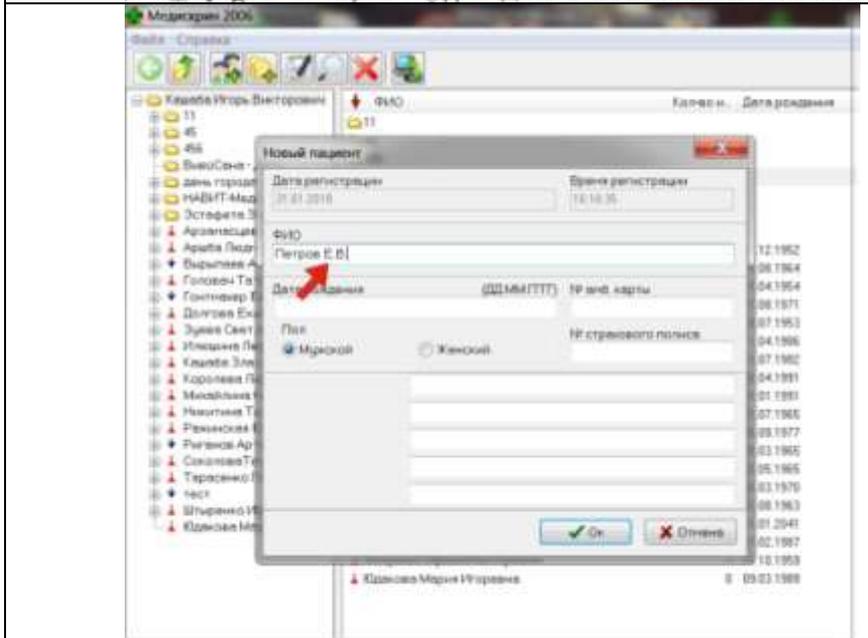

Занести данные пациента

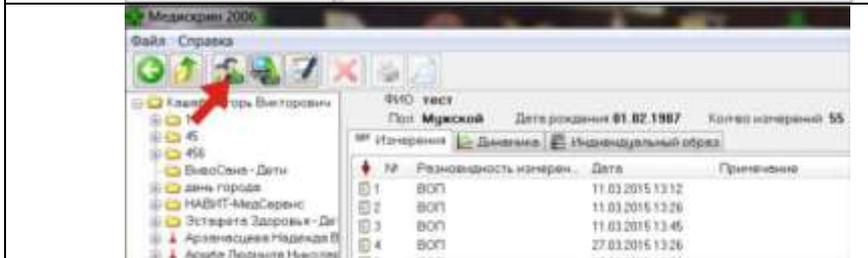


Начать измерение

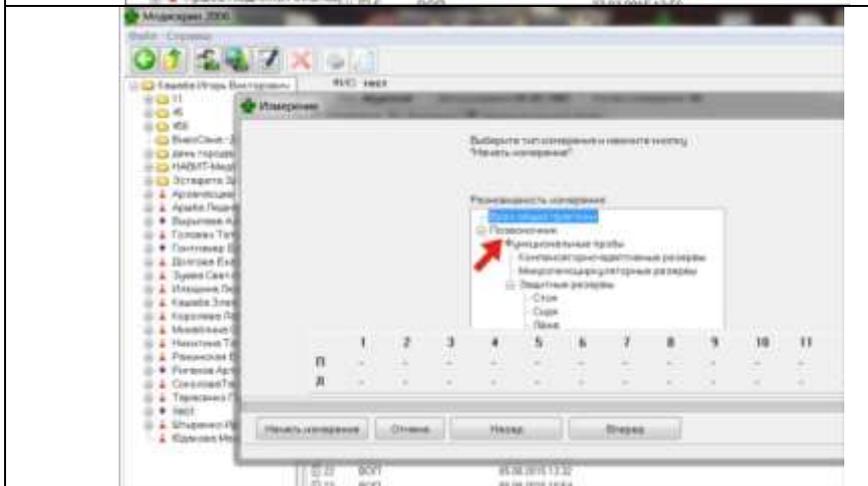

Выбрать тип измерения


		<p>Одеть пассивный электрод на левую руку.</p> <p>Калибровка: прижать «носик» активного электрода к кружку пассивного электрода.</p> <p>Появится значок «прогресса».</p>
		<p>Перед каждой точкой макаем "носик" активного электрода в смоченный ватный диск</p>
		<p>Начать измерение 24 зон</p>
		<p>Сам сенсор должен располагаться перпендикулярно коже в измеряемой точке.</p> <p>Прижатие должно быть ощутимым, но не болезненным.</p>

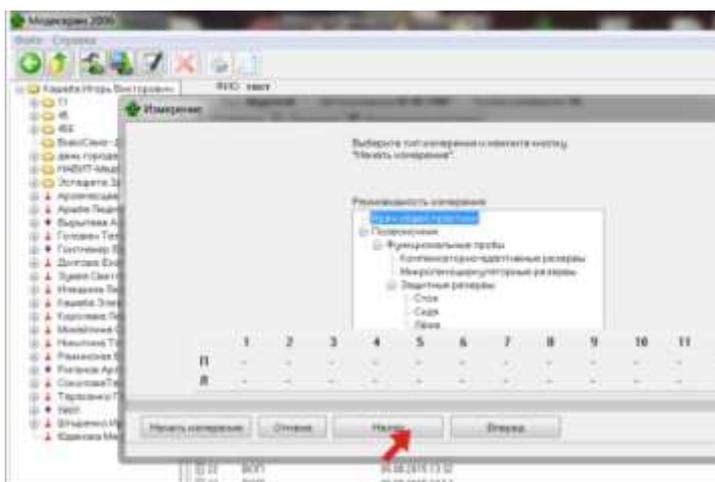

При сомнении отменяем последнее действие - "Назад", или выходим из программы без сохранения - "Отмена". Если кожа ороговевшая, то измерение не может быть выполнено из-за слишком большого электрического сопротивления. В этом случае надо нажать пункт "Вперед"



Закончили измерение - протереть активный и пассивный электроды спиртом.

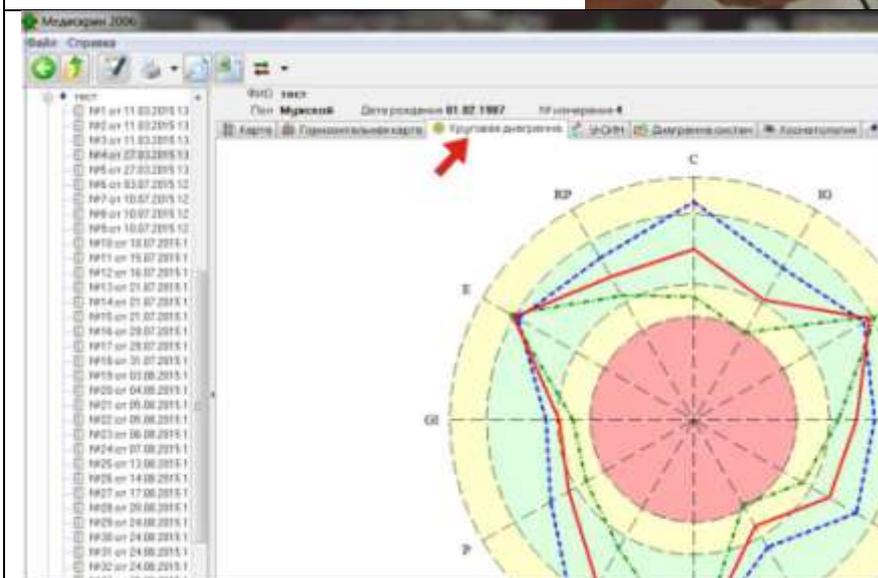

Диаграммы готовы. Выбираем диаграммы по горизонтали.